

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. N. 36/2023 e s.m.i., PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 SPETTROMETRO A FLUORESCENZA A RAGGI X (ED-XRF) DA BANCO PER ANALISI DEI METALLI SU FILTRI DI PARTICOLATO ATMOSFERICO DA DESTINARE AL LABORATORIO SPECIALISTICO NORD/OVEST SEDE DI GRUGLIASCO (TO)

**Fornitura nell'ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari
CUP I83C22000640005**

OGGETTO: Verbale tecnico conclusivo della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata per la valutazione tecnica delle offerte per la fornitura in oggetto, si è riunita per esaminare e deliberare in merito alle osservazioni trasmesse dalla ditta Malvern Panalytical S.r.l., relative ad alcune discordanze riscontrate nei limiti di rilevabilità (punti 8, 9, 10 e 11 del documento "Condizioni particolari di fornitura") dichiarati dall'operatore economico Nordtest S.r.l. rispetto a quelli indicati dal produttore Applied Rigaku Technologies nella nota applicativa ufficiale "EDXRF3133 – Analysis of Air Filters – U.S. EPA Sensitivity".

Le osservazioni di Malvern Panalytical S.r.l., pervenute tramite PEC in data 19 settembre 2025, riguardavano nello specifico i limiti di rilevabilità di alcuni elementi (Cd, As, Ni e Pb) e la presunta differenza significativa dei valori dichiarati rispetto a quanto riportato nella documentazione tecnica del produttore. La Commissione, preso atto della segnalazione, ha trasmesso all'Ufficio Acquisti, in data 6 ottobre 2025, un verbale tecnico contenente la richiesta di chiarimenti all'operatore economico Nordtest S.r.l. Tale richiesta era volta a verificare la conformità e l'autenticità dei dati dichiarati a supporto dell'offerta tecnica, nonché a chiarire le eventuali differenze con la documentazione prodotta da Applied Rigaku Technologies e a specificare le condizioni operative utilizzate per la determinazione dei limiti di rilevabilità, in relazione a quanto richiesto dal Capitolato tecnico.

La ditta Nordtest S.r.l., con propria comunicazione del 9 ottobre 2025, ha fornito riscontro puntuale alla richiesta della Commissione, precisando che i valori dichiarati derivano da protocolli di analisi condotti su strumentazione equivalente a quella oggetto di gara adottando condizioni sperimentali conformi alle specifiche previste dalla procedura. È stato inoltre chiarito che i limiti di rilevabilità riportati sono stati determinati sulla base di sequenze analitiche interne, condotte presso il laboratorio dell'azienda, e che tali dati sono ampiamente supportati da documentazione tecnica e tabulati analitici allegati all'offerta.

La Commissione, esaminata la documentazione e valutata la risposta pervenuta, ha ritenuto che le motivazioni fornite risultino coerenti con quanto richiesto dal Capitolato tecnico e adeguatamente giustificate dal punto di vista metodologico. Le differenze rilevate tra i valori dichiarati da Nordtest e quelli indicati nella nota applicativa Applied Rigaku Technologies sono riconducibili a differenti condizioni operative e sperimentali e non costituiscono elementi di differenza significativa ai fini del rispetto dei requisiti tecnici stabiliti in fase di gara.

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico
Codice fiscale - Partita IVA 07176380017
Struttura semplice - Acquisti beni e servizi
Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541
e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Si precisa, altresì, che tutti i requisiti prestazionali dichiarati e oggetto di valutazione tecnica saranno oggetto di specifica verifica in sede di collaudo dello strumento, nel corso del quale le prestazioni dichiarate dovranno essere replicate e riscontrate ai fini dell'accettazione definitiva della fornitura.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione giudicatrice ha ritenuto che la risposta della ditta Nordtest S.r.l. sia completa, tecnicamente fondata e conforme ai requisiti richiesti, non ravvisando la necessità di ulteriori approfondimenti. Conseguentemente, la Commissione conferma integralmente i punteggi tecnici già attribuiti in sede di valutazione tecnica dell'offerta, precedentemente approvati.

Il presente verbale sarà trasmesso all'Ufficio Acquisti, corredato dalla documentazione di riferimento, al fine di consentire la prosecuzione delle fasi successive della procedura di gara. Si richiede inoltre che, in sede di comunicazione formale:

- alla ditta **Nordtest S.r.l.** venga trasmesso riscontro dell'avvenuta valutazione della risposta e della conferma della coerenza tecnica delle dichiarazioni fornite, unitamente a copia dell'application note *"EDXRF3133 – Analysis of Air Filters – U.S. EPA Sensitivity"*
- alla ditta **Malvern Panalytical S.r.l.** venga comunicato che la Commissione ha preso in esame le osservazioni formulate, ha acquisito i chiarimenti dall'operatore economico Nordtest S.r.l. e, a seguito delle proprie verifiche, ha ritenuto le giustificazioni tecniche coerenti con quanto richiesto nel Capitolato, confermando pertanto i punteggi assegnati in fase di valutazione.

Il verbale viene allegato alla documentazione di gara unitamente alla nota applicativa Applied Rigaku Technologies *"EDXRF3133 – Analysis of Air Filters – U.S. EPA Sensitivity"* citata nella corrispondenza.

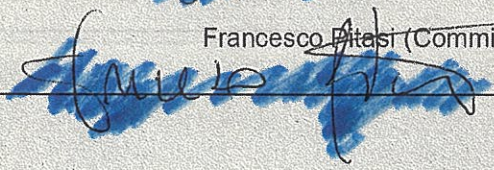
Letto, confermato, sottoscritto

Firmato digitalmente da:

MARCO FONTANA Marco Fontana (Presidente)

Data: 15/10/2025 09:33:18


Enrico Alesso (Commissario)


Francesco Pitasi (Commissario)

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU